

## 基本信息

设备名称：568GCP大冰箱

设备编码：BE07Q1MBQ4GHYPB70078

设备型号：冷链设备

设备状态：正常

所属单位：临沂市妇幼保健院

管理人员：杨海波(yanghaibo)

所属部门：药剂科

使用日期：2023-12-08 11:24:44

设备品牌：—

软件版本：90101568-V130003.002

## 传感器 - 温湿度

## 基础配置

传感器名称：温湿度

采集器编码：90101568

传感器路数：1

传感器类型：温湿度

温度上限：8℃

温度下限：2℃

湿度上限：—%RH

湿度下限：—%RH

## - 历史绑定明细

无采集更换记录

## - 信息汇总

| 序号 | 状态   | 持续时间        | 时间占比   | 超温次数 |
|----|------|-------------|--------|------|
| 1  | 温度正常 | 31天23小时59分钟 | 100.0% | —    |
| 2  | 高温报警 | 0分钟         | 0.0%   | 0    |
| 3  | 低温报警 | 0分钟         | 0.0%   | 0    |
| 4  | 湿度正常 | 31天23小时59分钟 | 100.0% | —    |
| 5  | 高湿报警 | 0分钟         | 0.0%   | 0    |
| 6  | 低湿报警 | 0分钟         | 0.0%   | 0    |

开始时间：2025-10-01 00:00 结束时间：2025-11-01 23:59 累计时间：31天23小时59分钟

温度最大值：5.50℃

温度最大值时间：2025-10-01 00:50:10

温度最小值：3.90℃

温度最小值时间：2025-10-13 00:10:10

温度平均值：4.73℃

湿度最大值：97.00%RH

湿度最大值时间：2025-10-01 15:08:10

湿度最小值：53.00%RH

湿度最小值时间：2025-10-02 11:16:10

湿度平均值：76.46%RH


MKT<sup>1</sup>：4.75℃

数据条数：23040


<sup>1</sup>MKT：平均动力学温度，用于反映产品储存或运输过程中的温度波动情况。

## - 设备曲线

温度曲线图

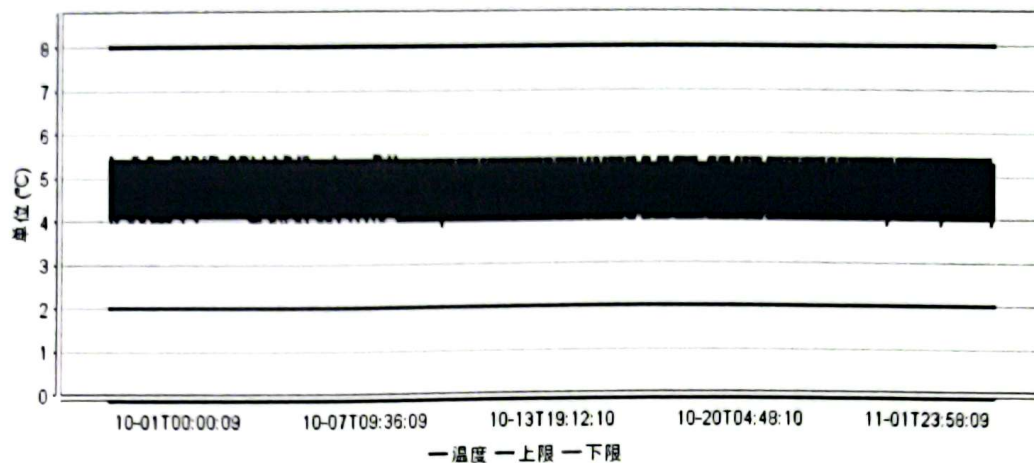

湿度曲线图

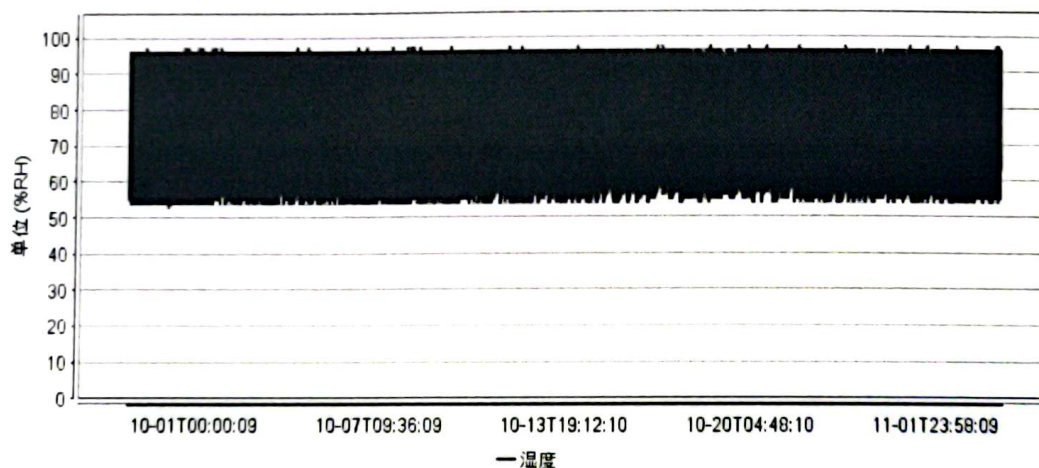

导出人：杨海波

导出时间：2025-12-02 09:59:24

复核人：2025.12.02

复核时间：2025.12.02